

BS Võ Văn Phong -

Thông khí nhân tạo được sử dụng trong gây mê toàn thân cho các bệnh nhân với tình trạng khí quản hoặc các đường cổ khí quản soát đường thở trên thanh môn (Supraglottic airway devices - SADs).

1. Các chỉ định thông khí nhân tạo trong mổ.

Máy thở trong gây mê ngày càng cho phép nhiều chỉ định thông khí, nhưng không phải tất cả các khả năng của máy thở được sử dụng trong đơn vị chăm sóc đặc biệt (Intensive care unit - ICU). Thuật ngữ cho các chỉ định thông khí không được chuẩn hóa, và so sánh giữa các kỹ thuật có sẵn trong ICU và phòng mổ có thể gây nhầm lẫn. Các chỉ định thông khí hỗ trợ và kiểm soát là có sẵn với hầu hết các máy gây mê.


Thông khí kiểm soát thể tích (Volume controlled ventilation - VCV) và thông khí kiểm soát áp lực (Pressure controlled ventilation - PCV) là các chỉ định chính của thông khí nhân tạo có kiểm soát được sử dụng trong gây mê toàn thân. Hỗ trợ áp lực (Pressure support) và kiểm soát áp lực đảm bảo thể tích (Pressure control with volume guarantee – PCV-VG) cũng có sẵn trên các máy gây mê thông minh.



Thông khí nhân tạo trong gây mê – ngạt i l n – Ph n 1

Viết bởi Biên tập viên



Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 17:28 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 23 Tháng 11 2019 10:57

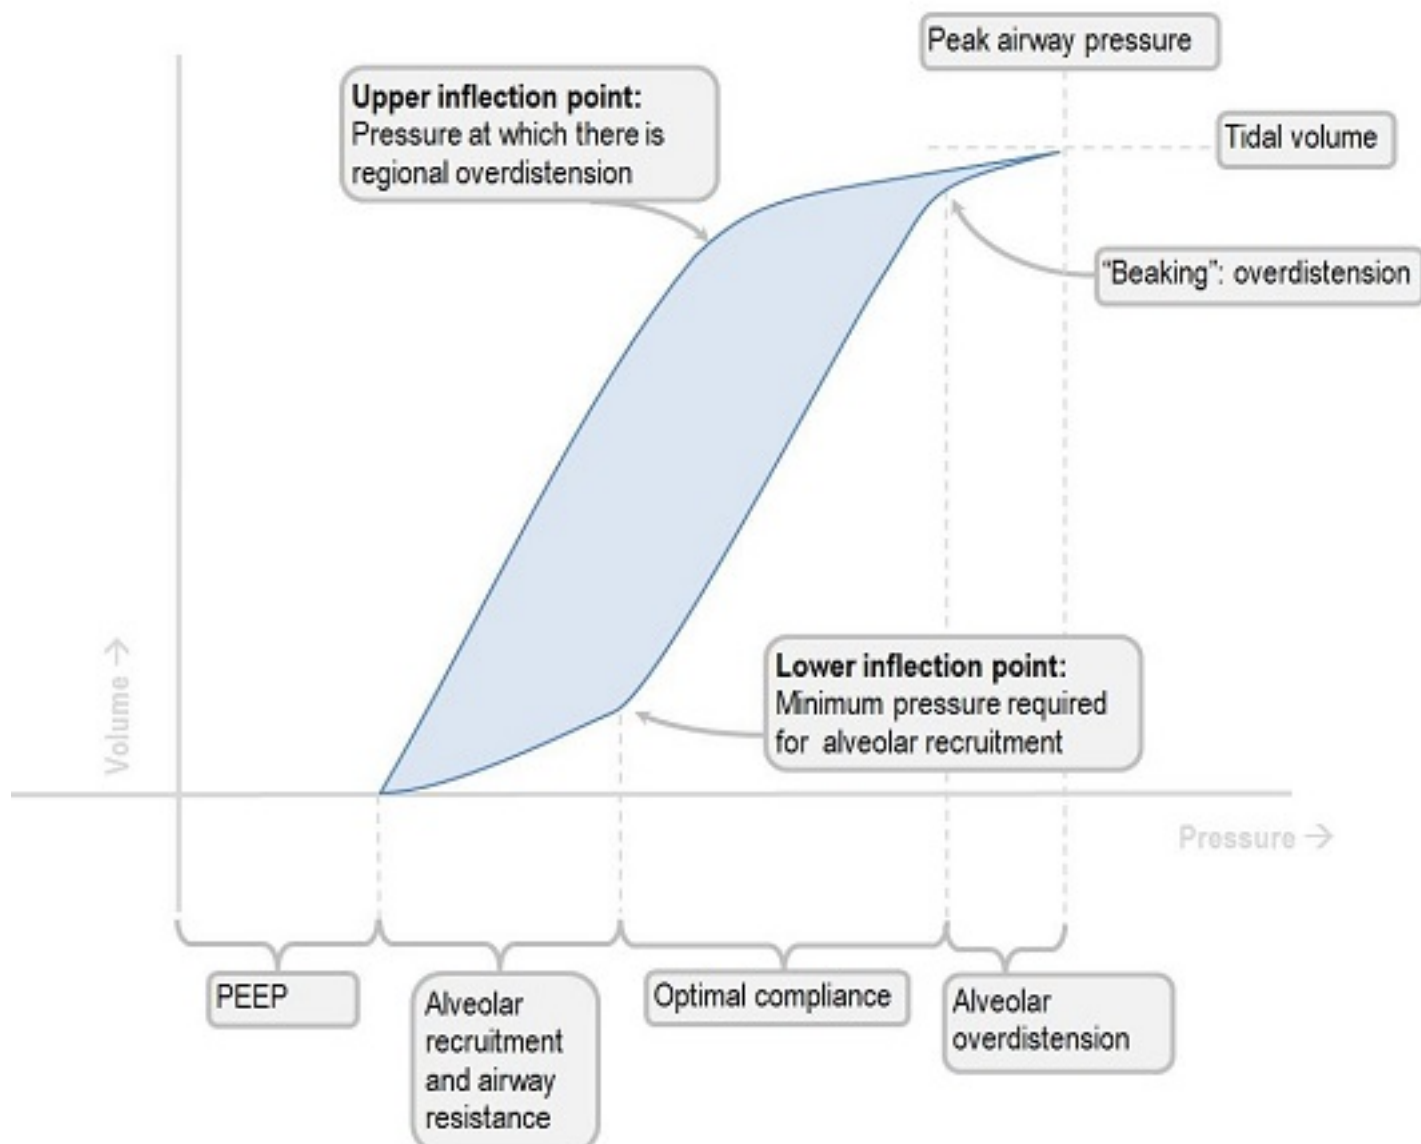

Thông khí nhân t_o trong gây mê ở người lớn – Phần 1

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 04 Tháng 11 2019 17:28 - Lần cập nhật cuối: Thứ bảy, 23 Tháng 11 2019 10:57

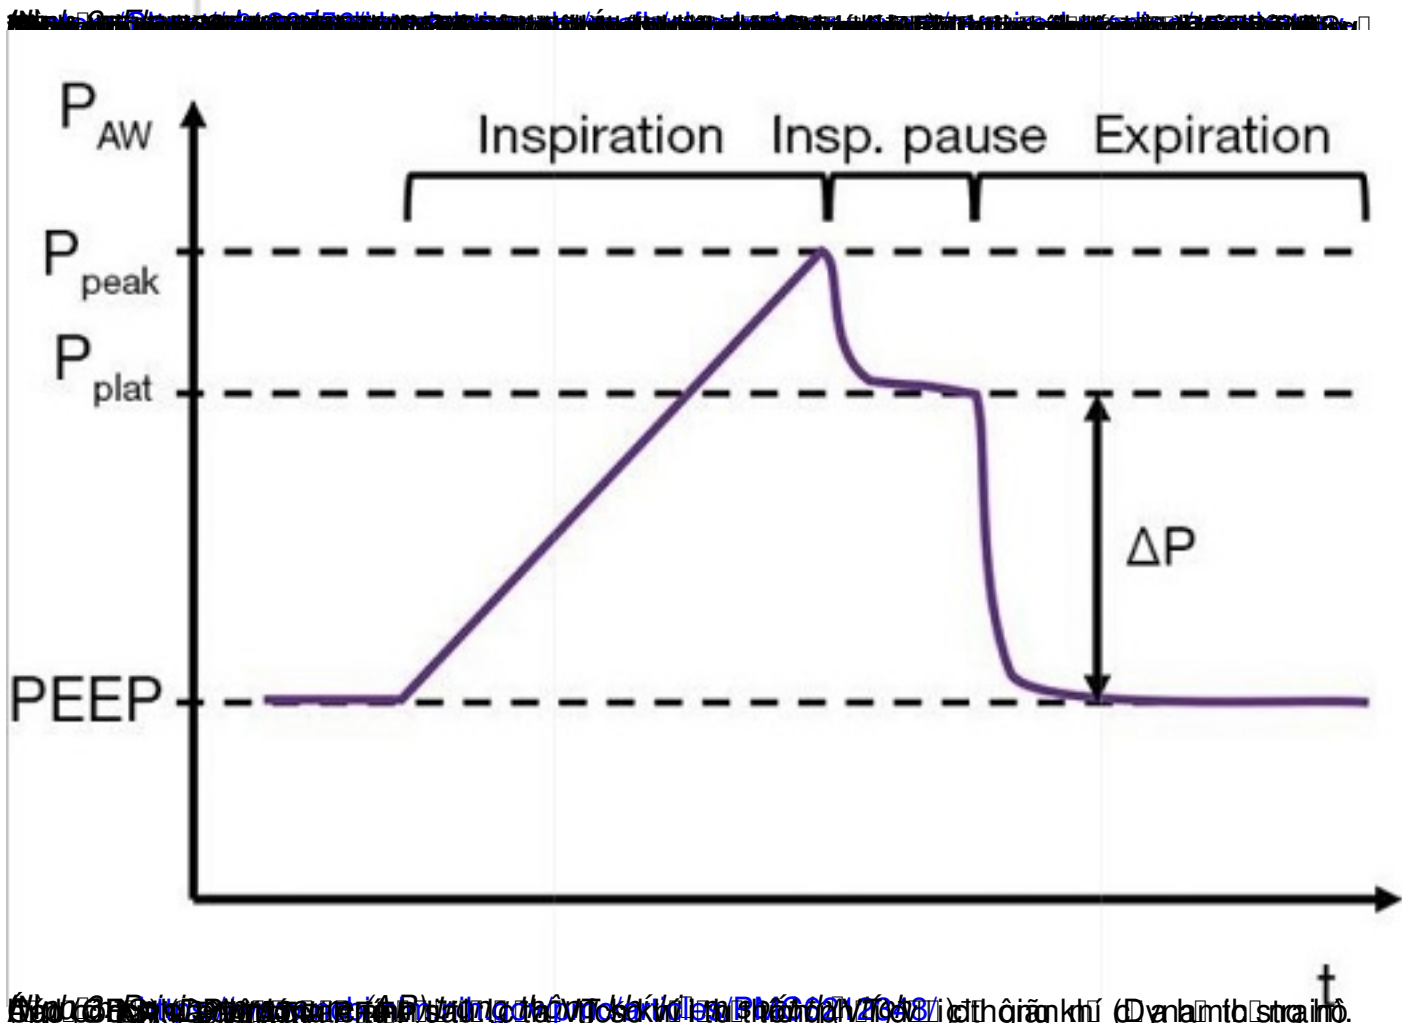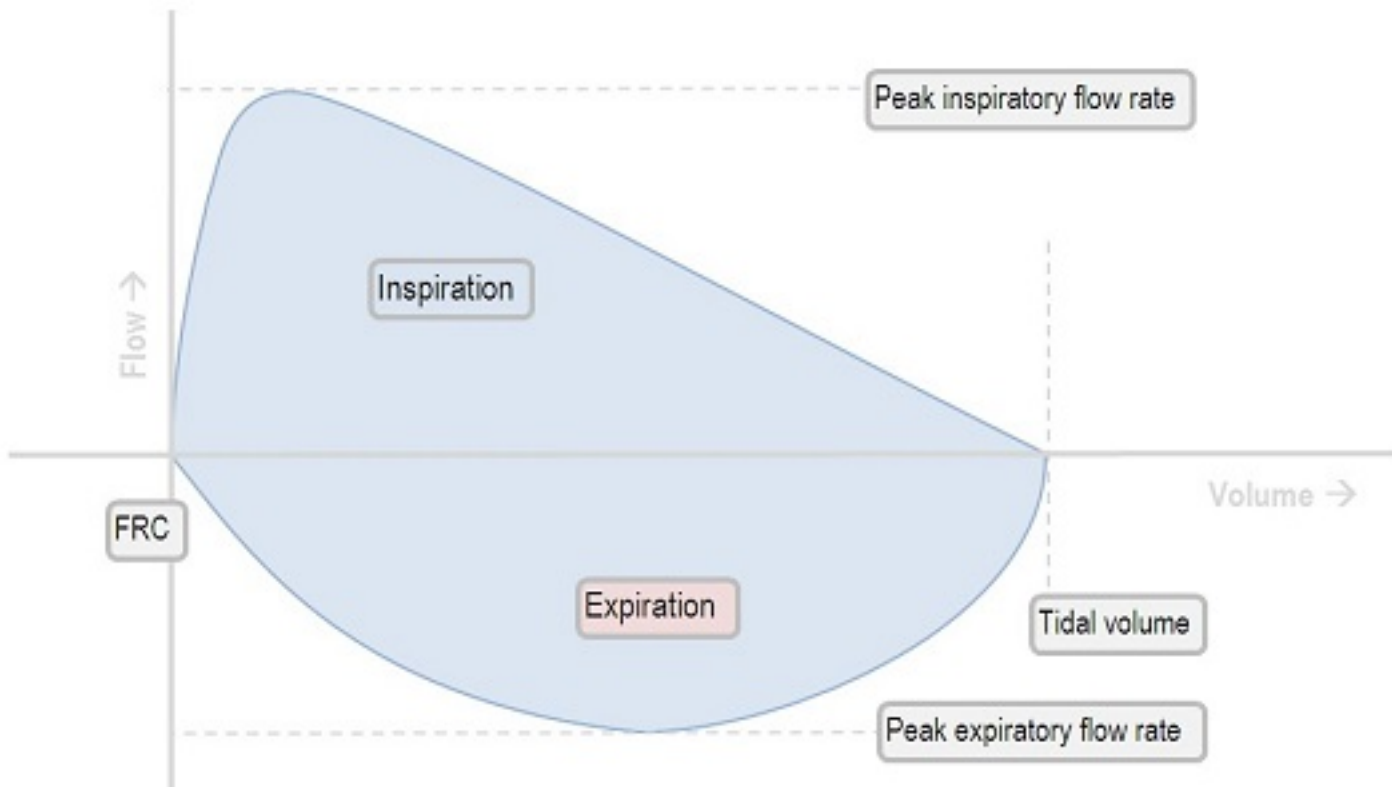

[Đáp án 8 \(Sinh viên không nên đưa ra câu trả lời sai khi làm Phấn 2/20/08\)](#) [cith giã khủ](#) (Dynamite straight).